


峰检测报告

打印日期和时间: 2023/12/13 17:40:37

文件名: File_231213_173708 - CorrectionData

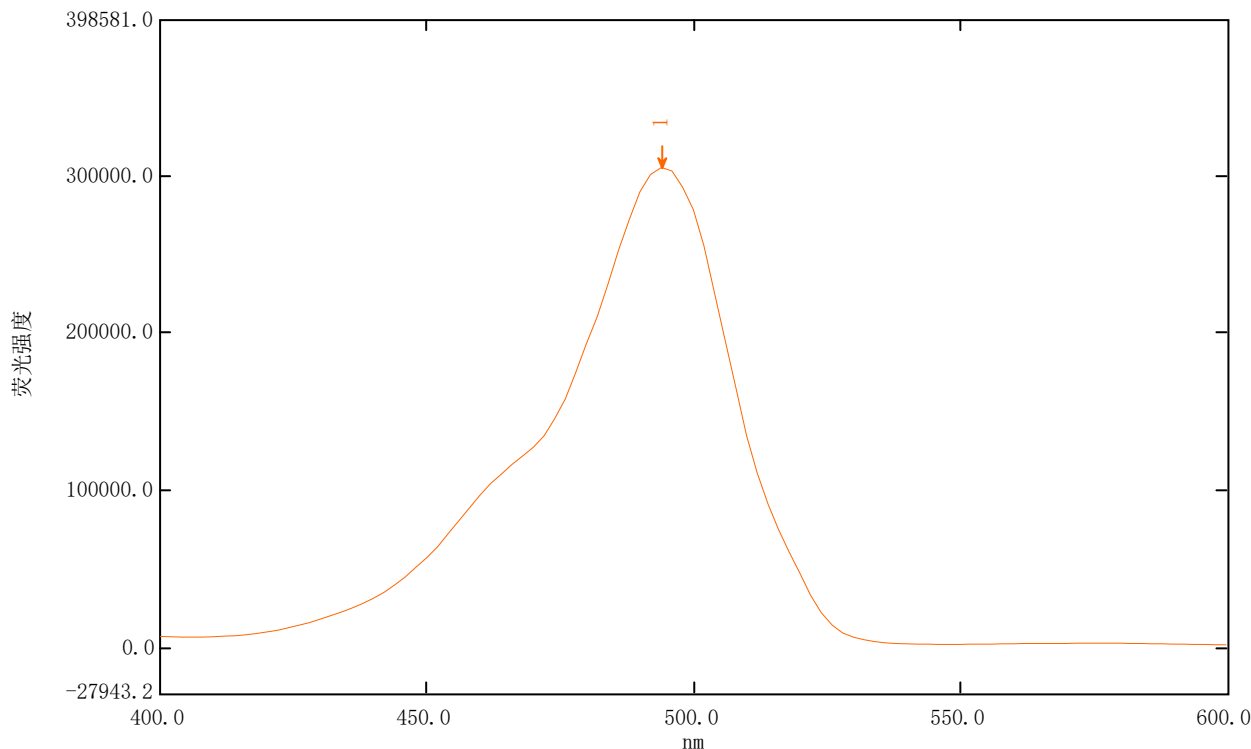

[峰检测表]

阈值: 1000.000

点数: 5

No.	P/V	Wavelengt	荧光强度	描述
1		494.0	305075.3	

软件信息

软件名称: LabSolutions RF

版本: 1.15

数据信息

数据: 非原始

样品名称:

样品ID:

Option:

分析者:

创建日期和时间: 2023/12/13 17:37:27

注释:

仪器信息

仪器名称: RF-6000

仪器类型: RF-6000系列

型号(S/N): RF-6000 (A40245701600SA)

[测定]

光谱类型: 激发光谱

激发光波长 开始: 400.0 nm

激发光波长 结束: 600.0 nm

发射光波长: 520.0 nm

数据间隔: 2.0 nm

扫描速度: 6000 nm/min

[仪器]

激发光带宽: 5.0 nm

发射光带宽: 5.0 nm

灵敏度: Auto

[附件]

附件: 无

[自动打印]

自动打印: 不执行

报告文件: