


峰检测报告

打印日期和时间: 2023/11/17 16:40:32

文件名: File\_231117\_163739 - CorrectionData

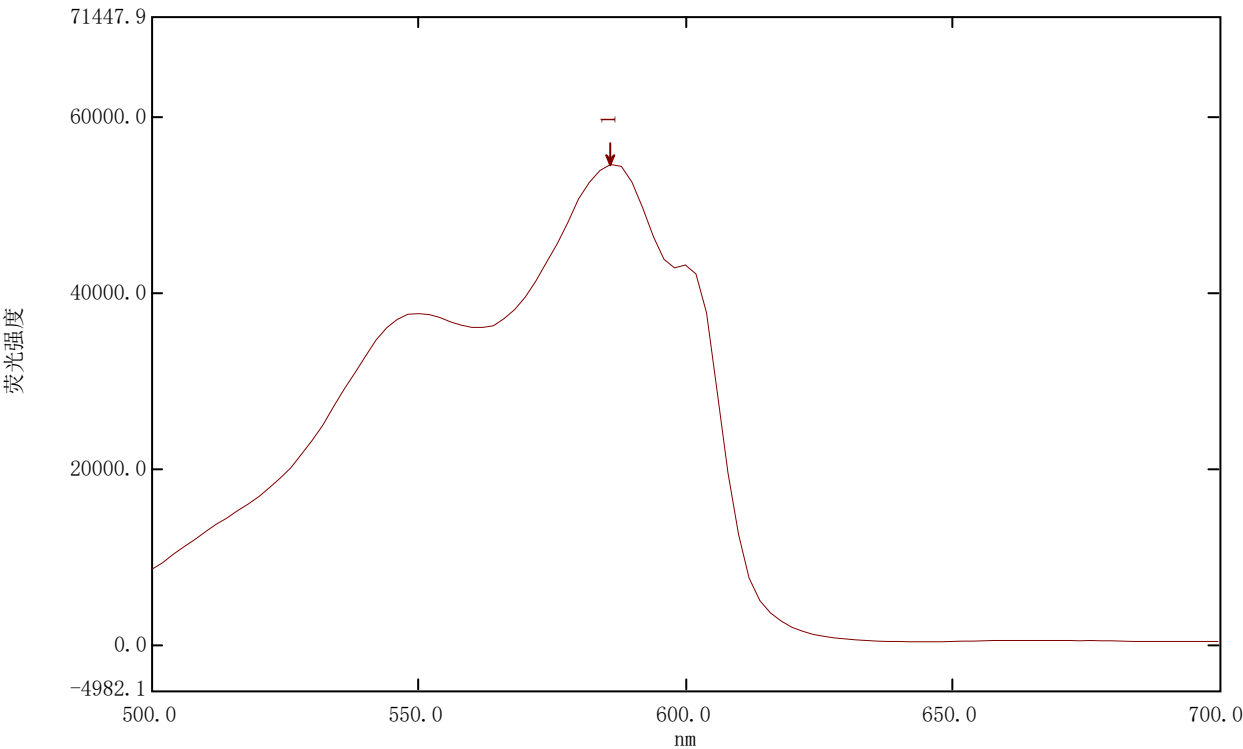

[峰检测表]

阈值: 1000.000  
点数: 7

| No. | P/V | Wavelengt | 荧光强度    | 描述 |
|-----|-----|-----------|---------|----|
| 1   |     | 586.0     | 54692.3 |    |

软件信息  
软件名称: LabSolutions RF  
版本: 1.15  
  
数据信息  
数据: 非原始  
样品名称:  
样品ID:  
Option:  
分析者:  
创建日期和时间: 2023/11/17 16:38:00  
注释:

仪器信息  
仪器名称: RF-6000  
仪器类型: RF-6000系列  
型号(S/N): RF-6000 (A40245701600SA)

[测定]  
光谱类型: 激发光谱  
激发光波长 开始: 500.0 nm  
激发光波长 结束: 700.0 nm  
发射光波长: 606.0 nm  
数据间隔: 2.0 nm  
扫描速度: 6000 nm/min

[仪器]  
激发光带宽: 5.0 nm  
发射光带宽: 5.0 nm  
灵敏度: Auto

[附件]  
附件: 无

[自动打印]  
自动打印: 不执行  
报告文件: